

## Slovenský metrologický ústav

ROZHODNUTIE č. 960/141/93 - 1057/1D/ČSMÚ zo dňa 22.07.1993  
o doplnku č.1 k Schváleniu typu meradla

TCS 141/91 - 1057

Na žiadosť firmy Scheidt & Bachmann GmbH, Mönchengladbach,  
Slovenský metrologický ústav Bratislava vydáva doplnok č.1  
k Schváleniu typu meradla TCS 141/91 - 1057.


Týmto doplnkom sa rozširuje schválenie typu výdajného stojana  
ET 200 a MZ 4000, výrobcu Scheidt & Bachmann GmbH, Breite  
Straße 132, D-4050 Mönchengladbach 2 (SRN), v súlade s prílo-  
hou. Toto rozhodnutie platí do 31.01.2002.

Z d o v o d n e n i e

Uvedený typ meradla spĺňa metrologické požiadavky, ako bolo  
zistené technickou skúškou vykonanou našou organizáciou.

P o u č e n i e o o d v o l a n í

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do  
15 dní odo dňa jeho oznámenia.



Ing. Róbert Spurný, CSc.  
riaditeľ SMÚ

Príloha

VÝDAJNÉ STOJANY  
fy Scheidt & Bachmann typu MZ 5000

TCS 141/91 - 1057

1. Z á k l a d n é ú d a j e

Výrobca : Scheidt & Bachmann, GmbH, Breite Straße 132,  
D-4050 Mönchengladbach 2 (SRN)  
Dodávateľ : Scheidt & Bachmann, GmbH, Breite Straße 132,  
D-4050 Mönchengladbach 2 (SRN)

2. P o p i s d o p l n k u


Výdajné stojany typu MZ 5000 sú konštrukčne zhodné so stojan-  
mi rady MZ 4000, od ktorých sa odlišujú len vonkajším vzhľa-  
dom. Nové vyhotovenie zodpovedá obr. 1.

3. S k ú š k a


Skúška pre vydanie rozhodnutia o doplnku sa vykonala posúde-  
ním technickej dokumentácie a porovnaním so stojanom MZ  
4000. Skúškou bolo zistené, že meradlo vyhovuje požiadavkam  
ČSN 25 7501 a 25 7503.

Základné technické údaje výdajného stojana, doba platnosti  
overenia a ostatné náležitosti povolenia TCS 141/91 - 1057  
ostávajú nezmenené. Mení sa len štítkový údaj o type meradla  
v časti 5 ad b) pôvodného povolenia na MZ 50xx.

Vypracoval : I. Chren



Ing. I. Mikulecký, CSc.  
vedúci oddelenia/223

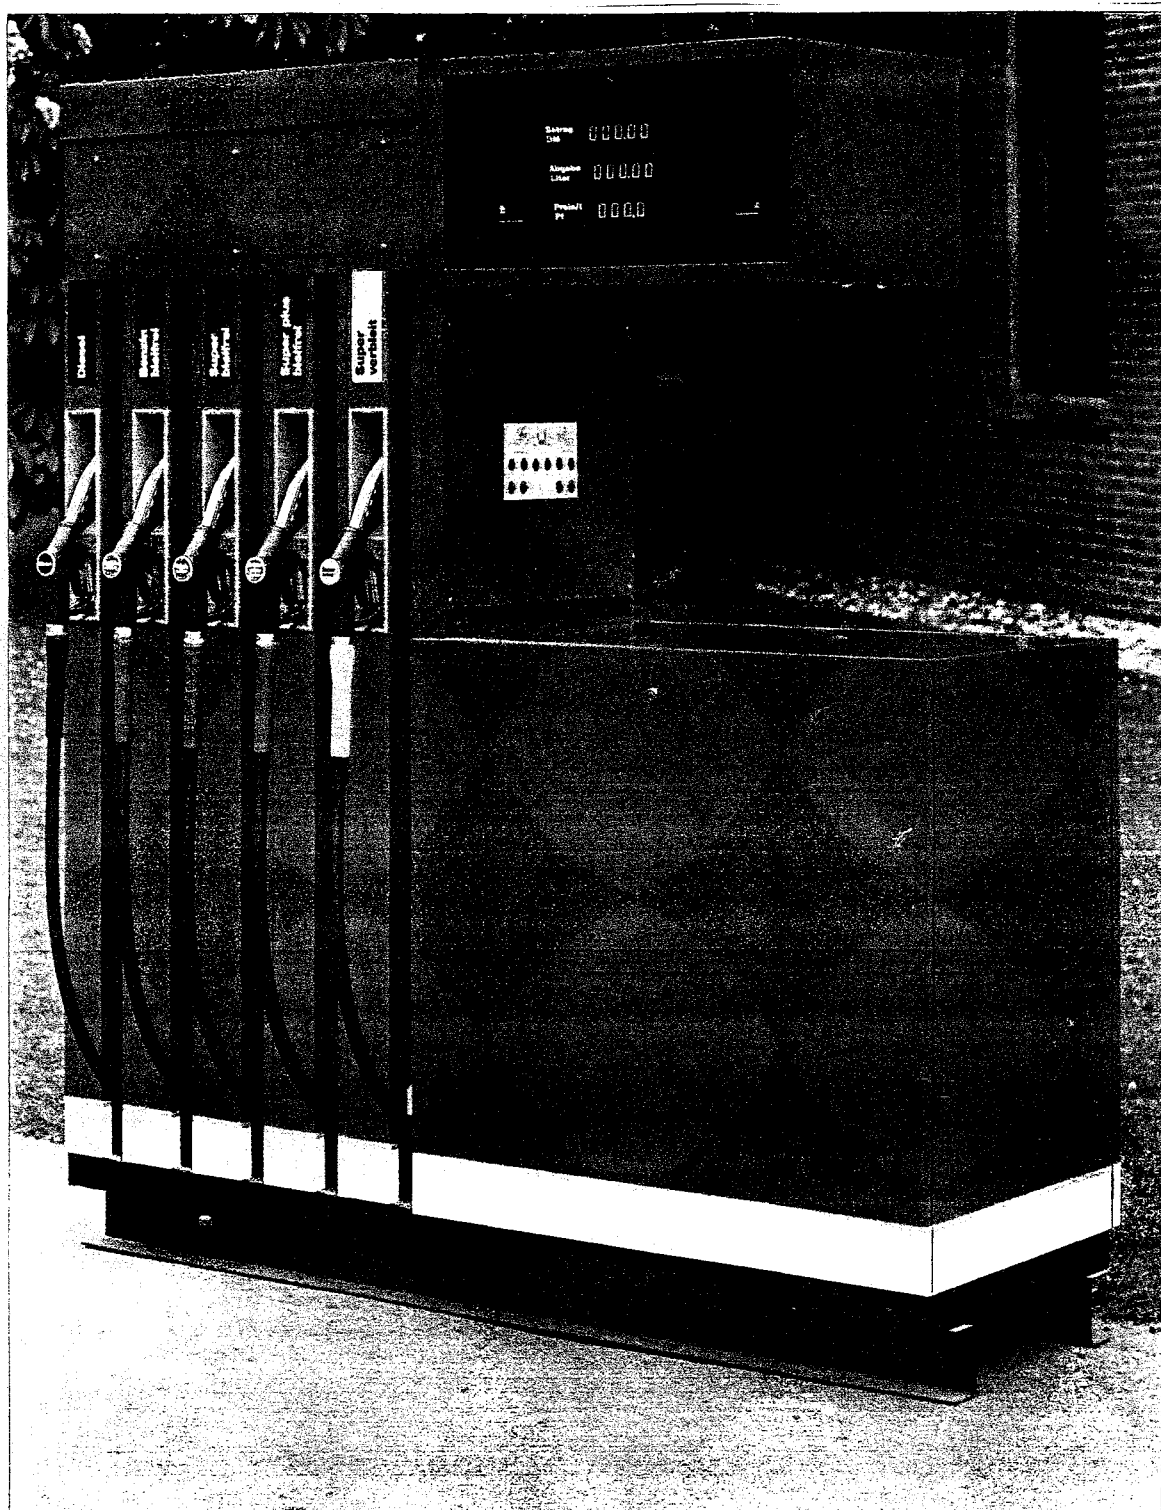

Obr. 1 : Vydajný stojan typu MZ 5000

