

811

**ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

Štefanovičova 3, 814 39 Bratislava

D O D A T O K č . 2

zo dňa 14.04.1997

k Rozhodnutiu č. 960/128/95-128 zo dňa 04.07.1995, ktorým sa vydalo

**O S V E D Č E N I E
O S C H V Á L E N Í T Y P U M E R A D L A**

pre meradlo so štátnou značkou schváleného typu

T S Q 1 2 8 / 9 5 - 1 2 8

Na žiadosť Mettler-Toledo, spol. s r.o., Lombardiniho 24, 831 03 Bratislava, SR, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe § 7 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii vydáva Dodatok č. 2, ktorým sa rozširuje schválenie typu elektronických váh III. triedy presnosti, typu SPIDER o typ SPIDER S ako určeného meradla pri dodržaní technických údajov a podmienok, uvedených v prílohe tohto Dodatku.

Výrobca: Mettler-Toledo


Zdôvodnenie:


Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené skúškou typu vykonanou Slovenským metrologickým ústavom Bratislava.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto Dodatku k Rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku. Obsahuje 2 strany.

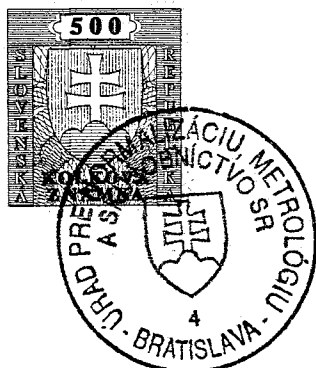


Ing. Jozef Orlovský
riaditeľ odboru metrológie
ÚNMS SR

Príloha Dodatku č.2
k Rozhodnutiu o schválení typu meradla TSQ 128/95-128
zo dňa 4.7.1995

Typ meradla : Elektronické váhy SPIDER S

Výrobca meradla : Firma Mettler-Toledo

Dodatok č.2 je predmetom nasledujúcich zmien a doplnkov :

Príloha k rozhodnutiu č.960/128/95-128 sa v bode 2 dopĺňa o :

Váhy vyrobené z nehrdzavejúcej ocele majú označenie SPIDER S. Konštrukciou a metrologickými parametrami sú zhodné s ostatnými váhami typovej rady SPIDER, v prevedeniach SPIDER 1, SPIDER 2, SPIDER 3.

Príloha k rozhodnutiu č.960/128/95-128 sa v bode 3 dopĺňa o :

typ	Max kg	Min g	e g	d g	trieda presnosti
Spider 3S	3	20	1	1	III
Spider 6S	6	40	2	2	III
Spider 15S	15	100	5	5	III
Spider 35S	35	200	10	10	III
Spider 60S	60	400	20	20	III
Spider 60LS	60	400	20	20	III
Spider 150S	150	1000	50	50	III
Spider 300S	300	2000	100	100	III
Spider 600S	600	4000	200	200	III

Max - horná medza váživosti

Min - dolná medza váživosti

e - hodnota overovacieho dielika

d - hodnota dielika



Vypracovala : PharmDr.J.Bičárová

Ved.lab.hmotnosti a hustoty
Ing.R.Spurný, CSc.

Bratislava dňa 14.4.1997

Bičárová
Spurný
Kneppo
Doc.Ing. P.Kneppo, DrSc.
riaditeľ SMÚ

